CART ON | SkyLabs

카트 온 (CART ON)

소프트웨어 매뉴얼

SMS-01(Rev.A-20260116)

www.skylabs.io

Copyright© Sky Labs Inc. All rights reserved

목차

1. 유의사항 3

2. 진행 방법

2-1. 로그인 4

2-2. 혈압 보정 및 측정 5

3. 카트링 업데이트 7

4. 홈 화면 구성 8

1. 유의사항

- 카트 온 앱은 혈압 보정과 측정 시작 기능만 지원합니다. 데이터 확인 및 측정 종료를 원하시면 환자와 카트링을 연결했던 소프트웨어를 사용해 주세요.
- **안드로이드 12 이상만 지원합니다.**

2. 진행 방법

2-1. 로그인

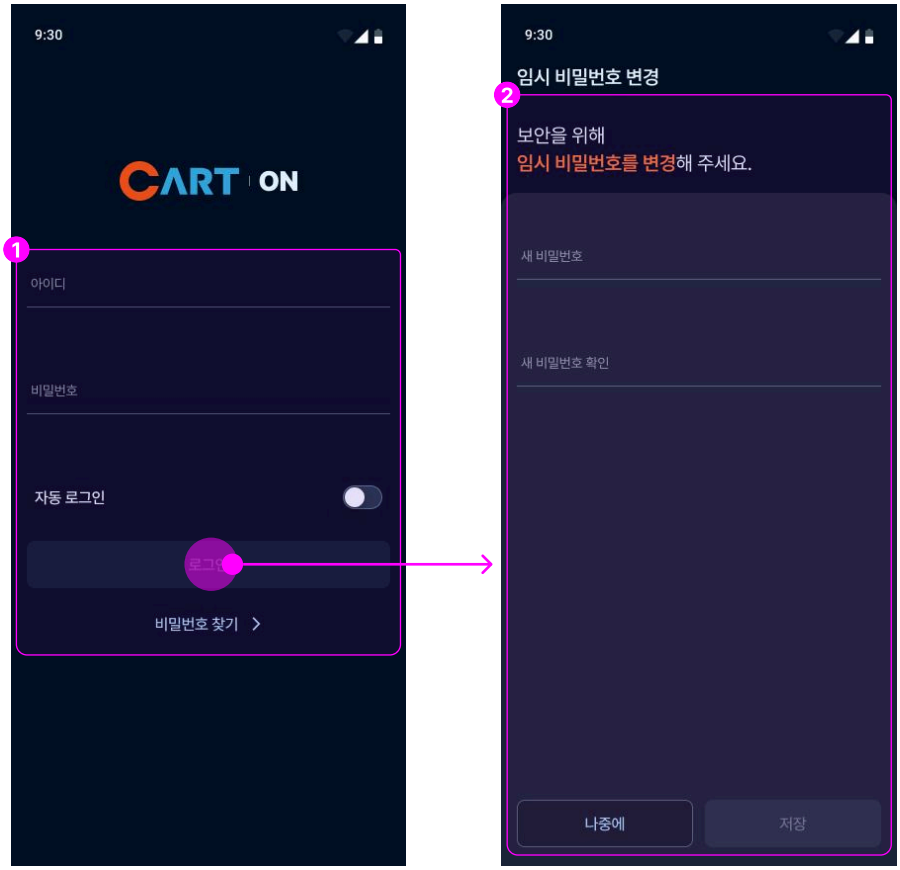

순서	내용
1	제품 구매 시 전달받은 계정 정보(아이디, 비밀번호)로 앱에 로그인하세요.
2	최초 로그인 시 임시 비밀번호를 변경하세요. 변경하지 않으면 사용이 불가합니다.

Note

- 보안 상의 이유로 앱의 동시 접속은 허용되지 않습니다.
- 앱은 자동 로그인 설정이 되었더라도 30일 동안 미 접속 시 자동 로그아웃 됩니다.

2. 진행 방법

2-2. 혈압 보정 및 측정

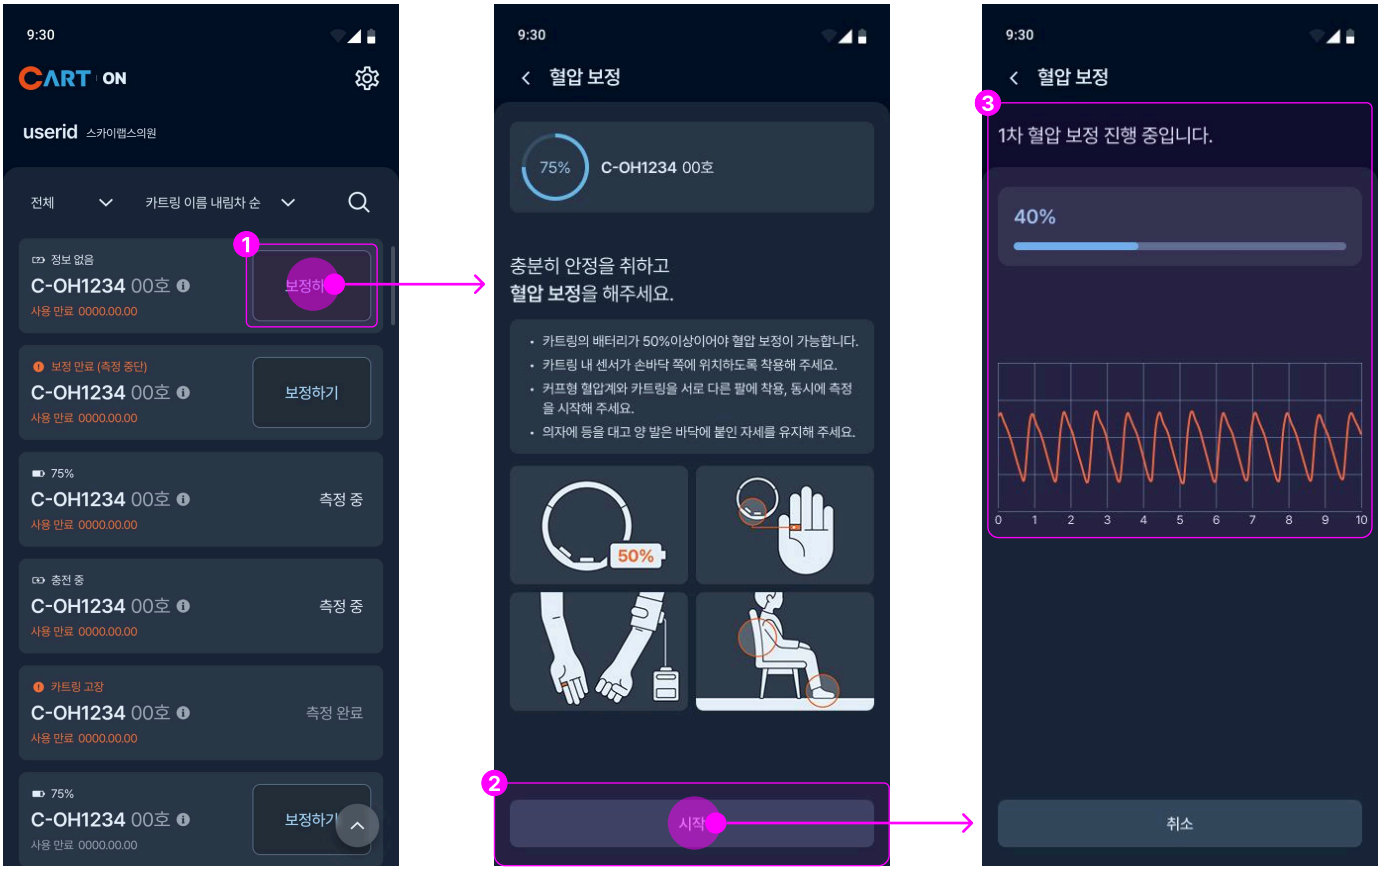

순서	내용
1	카트링 목록 내 [보정하기] 를 클릭하세요.
2	카트링과 커프형 혈압계를 모두 착용 후 [시작]을 클릭하세요.
3	**혈압 측정이 완료될 때까지 올바른 자세를 유지하세요.**

Note

- 보정은 **카트링의 배터리가 50% 이상**이어야 가능합니다.
- 보정은 **총 2번** 진행됩니다. 단, 1차 혈압 값과 2차 혈압 값의 차이가 크면 3차 보정이 진행될 수 있습니다.
- 보정은 임시 저장이 되지 않으며 중단하면 처음부터 다시 시작해야 합니다.

2. 진행 방법

2-2. 혈압 보정 및 측정

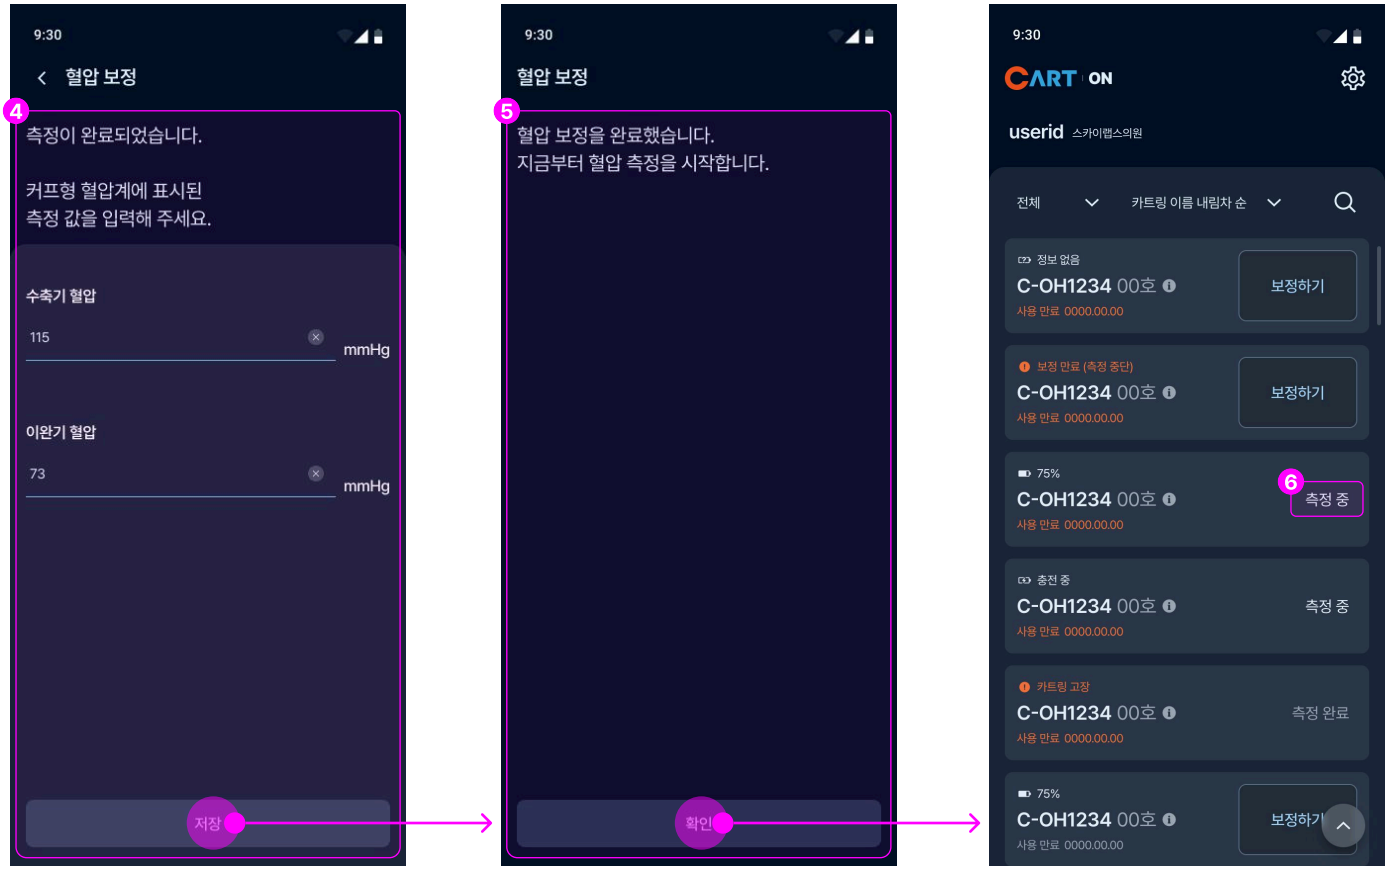

순서	내용
4	커프형 혈압계에 나타난 수축기, 이완기 혈압을 입력 후 [저장]을 클릭하세요.
5	2차 보정까지 완료되면 혈압 측정이 시작됩니다.
6	카트링 목록 내 [보정하기] > [측정 중]으로 변경되었는지 확인하세요.

Note

- 보정은 **카트링의 배터리가 50% 이상**이어야 가능합니다.
- 보정은 **총 2번** 진행됩니다. 단, 1차 혈압 값과 2차 혈압 값의 차이가 크면 3차 보정이 진행될 수 있습니다.
- 보정은 임시 저장이 되지 않으며 중단하면 처음부터 다시 시작해야 합니다.

3. 카트링 업데이트

카트링 펌웨어 업데이트가 필요하면 혈압 보정 시작 전 알림이 표시됩니다.
업데이트 후 혈압 보정을 진행하세요.

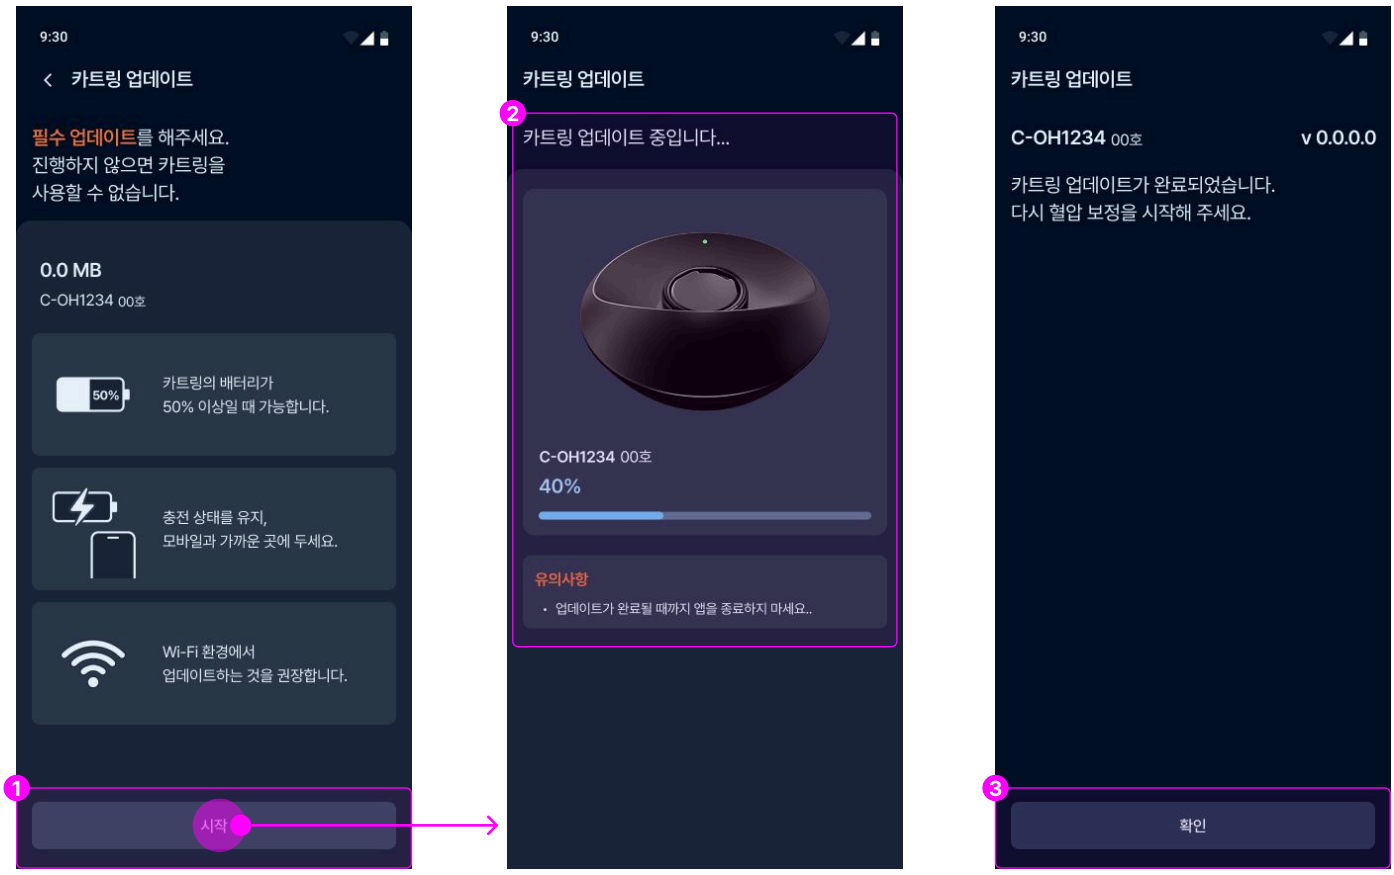

순서	내용
1	카트링 업데이트 알림 내 [시작]을 클릭하세요.
2	약 30초 정도 소요됩니다.
3	카트링 업데이트가 완료되면 [확인]을 클릭하세요.

Note

- 카트링 업데이트를 진행 하지 않으면 일부 기능 사용이 제한될 수 있습니다.
- 카트링 업데이트는 **카트링 배터리가 50% 이상이거나 충전 중일 때 가능**합니다.
- 카트링 업데이트 중에는 카트링과 모바일을 가까이에 두세요.

4. 홈 화면 구성

홈 화면 새로고침
환자 연결,
카트링 이름 기준으로
목록 정렬
9:30
CART ON
앱 정보 및 계정 관리
로그인한 계정 정보
userid 스카이랩스의원
카트링 상태별 분류
전체
카트링 이름 내림차 순
카트링 이름 검색
정보 없음
C-OH1234 00호
사용 만료 0000.00.00
보정하기
혈압 보정 화면 진입 및
현재 상태 표시
교품 대상 카트링
C-OH1234 00호
보정하기
카트링 시리얼 번호 및
모델명 표시
시리얼 번호 F250610-733D1
모델명 SL-MRD1K10
75%
C-OH1234 00호
측정 중
사용 만료 0000.00.00
카트링 목록
충전 중
C-OH1234 00호
측정 중
사용 만료 0000.00.00
배터리 잔량,
카트링 이상 여부,
혈압 보정 기간 만료 여부 표시
카트링 고장
C-OH1234 00호
측정 완료
사용 만료 0000.00.00
카트링 사용 만료일 표시
75%
C-OH1234 00호
사용 만료 0000.00.00
보정하기
최상단 이동

저희 스카이랩스

카트 온 (CART ON)을

이용해 주셔서 감사합니다.

홈페이지 www.skylabs.io

고객센터 1599 - 1941

SkyLabs